

คำร้อง :  ฉบับใหม่  ฉบับเปลี่ยนแปลง/แก้ไข  ฉบับยกเลิก/หมดอายุ  ยืนยันการใช้เอกสาร  
 ขอสำเนาควบคุม  ขอสำเนาไม่ควบคุม  ขออนุมัติทำลาย  อื่นๆ \_\_\_\_\_

ชนิดเอกสารควบคุม :  คู่มือคุณภาพ (QM)  ขั้นตอนการดำเนินงาน (QP)  วิธีปฏิบัติงาน (WI)  
 เอกสารสนับสนุน (SD)  แบบฟอร์ม (FM)  อื่นๆ เอกสารภายนอก (ED)

## SIGNATURE

วันที่ส่งเอกสาร/ขอดำเนินการ : 24/07/2566      หน่วยงาน : LES


ผู้จัดเตรียม/ผู้ขอดำเนินการ : นางสาวชกร ไกรสรสวัสดิ์      แพลตฟอร์มโดย :  
 อนุมัติการทบทวนเอกสาร (ลำดับที่ 1) : นางจริยา แสนสมบัติ      วันที่บังคับใช้ : 1 ส.ค. 2566 (สำหรับ DCC)  
 อนุมัติการทบทวนเอกสาร (ลำดับที่ 2) : นายทัญญู แสนโกชน์

หมายเลขเอกสารควบคุม (DOC. NO.) : ED-LE-004      ลำดับที่ (REV.) : 00

ชื่อเอกสารควบคุม (DOC. TITLE) : เกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04)

เอกสารแนบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง : \_\_\_\_\_

## รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / แก้ไขเอกสารควบคุม

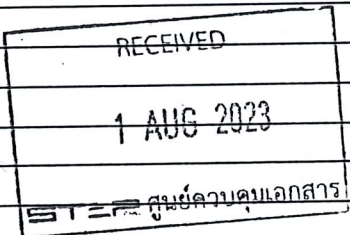หัวข้อ / ตำแหน่ง	รายละเอียดก่อนการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข	รายละเอียดหลังการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข
		ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่
		

## รายละเอียดการทบทวนเอกสารควบคุม

วันที่ประชุมทบทวน : 13/07/2566      เวลา : 13.00-15.00 น.      สถานที่ : A408

รายชื่อประชุมทบทวนและผู้เกี่ยวข้อง : นายทัญญู แสนโกชน์, นางจริยา แสนสมบัติ, นางสาวรัตติกาล อยู่สุภาพ, นางสาวชกร ไกรสรสวัสดิ์

อนุมัติการใช้เอกสารโดย :

(นางสาวเนลิน เชื้อมโนชาญ)

(QMR)

CONTROLLED

1 AUG 2023

STEP ศูนย์ควบคุมเอกสาร

## ส่วนการแจกจ่ายเอกสาร / เรียกคืนเอกสาร (สำหรับเจ้าหน้าที่ DCC)

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร	หน่วยงาน/ฝ่าย	แจกจ่ายเอกสาร		เรียกคืนเอกสาร		หมายเหตุ
			ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ	ผู้รับเอกสาร	วันที่คืน	
ED-LE-004	เกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04)	LE	กช	27/7/6			

สำเนา

เอกสารภายนอก





# เกณฑ์กำหนดการใช้ เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04)

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2201-7125 0-2201-7165 0-2201-7134

โทรสาร : 0-2201-7126 0-2201-7201

<http://www.dss.go.th>

สำเนา

LA-R-04-14/11-17

เอกสารภายนอก

## บทนำ

เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นเกณฑ์กำหนดในการใช้เครื่องหมายการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ILAC P8 - ILAC Mutual Recognition Arrangement : Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation status by Accredited Laboratories. และใช้เป็นเกณฑ์กำหนดในการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ของห้องปฏิบัติการ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ILAC-R7: Rules for the Use of the ILAC MRA Mark

ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จะได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการรับรองและเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ซึ่งต้องปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดในเอกสารฉบับนี้

# สำเนา

## เอกสารภายนอก

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	i
สารบัญ	ii
1. ขอบข่าย	1
2. นิยาม	1
3. การใช้และห้ามใช้เครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA	2
4. รูปแบบและการแสดงเครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA	3
5. การยุติและการยกเลิกการใช้เครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA	4
ภาคผนวก ก: เครื่องหมายการรับรอง	5
ภาคผนวก ข: เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA	7

# สำเนา

## เอกสารภายนอก

## 1. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์กำหนดในการใช้เครื่องหมายการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 และ ISO Guide 34 หรือ ISO 17034 รวมถึงข้อกำหนดของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

## 2. นิยาม

- 2.1 สำนัก หมายถึง สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- 2.2 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ซึ่งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
- 2.3 ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญที่ได้รับการรับรอง ซึ่งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
- 2.4 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง ซึ่งผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
- 2.5 เครื่องหมายการรับรอง หมายถึง เครื่องหมายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการให้การรับรอง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการและหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และเครื่องหมายนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
- 2.6 เครื่องหมาย ILAC MRA หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement; MRA)

สำนัก

เอกสารภายนอก

2.7 เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หมายถึง เครื่องหมาย ILAC MRA คู่กับเครื่องหมายการรับรอง

### 3. การใช้และห้ามใช้เครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA

3.1 ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองโดยสำนักเท่านั้น ที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการรับรอง (เฉพาะห้องปฏิบัติการสามารถใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA) บนวัสดุสำนักงาน ใบเสนอราคา รายงานผลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ใบรับรองวัสดุอ้างอิง วัสดุอ้างอิง และแผ่นพับ และ/หรืออาจใช้เครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

สำนักไม่อนุญาตให้ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง อ้างถึงการรับรองในผลิตภัณฑ์กระบวนการ ระบบ หรือ บุคลากรของห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และไม่อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรืออ้างถึงการรับรองบนผลิตภัณฑ์หรือส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบ และบนนามบัตรที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงการรับรองบุคลากร

3.2 ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้อื่นโดยมิให้เกิดความเข้าใจผิดในขอบข่ายและข้อจำกัดของการรับรองของสำนัก ความรับผิดชอบนี้รวมถึงข้อมูลในข้อเสนอ/การประมูลงาน งานที่รับผิดชอบ การรายงานผล การใช้ผู้รับเหมาช่วง หรือการโฆษณาในการให้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ

3.3 ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง ต้องไม่ใช่เครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรืออ้างถึงการรับรองในเอกสารหรือรายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หรือใบรับรองวัสดุอ้างอิง หรือวัสดุอ้างอิงที่ไม่มีกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง

สำเนา

เอกสารภายนอก

3.4 เมื่อแสดงเครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรือการอ้างถึงการรับรองบนรายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หรือใบรับรองวัสดุอ้างอิง หรือวัสดุอ้างอิงหรือใบเสนอราคา ที่รวมถึงหรืออ้างถึงกิจกรรมที่ไม่ได้รับการรับรอง กิจกรรมที่ไม่ได้รับการรับรองดังกล่าวต้องมีการชี้บ่งไว้อย่างชัดเจน

3.5 สำนักจะดำเนินการตามความเหมาะสม เช่น ให้ห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ได้รับการรับรองทำการปฏิบัติการแก้ไข ยกเลิกการรับรอง หรือประกาศเผยแพร่ถึงกรณีในห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง แสดงเครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรือการอ้างถึงการรับรองไม่ถูกต้อง

3.6 หากห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองมีข้อสงสัยในการแสดงเครื่องหมายการรับรองหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมีข้อสงสัยในการแสดงเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรือการอ้างถึงการรับรอง ควรสอบถามและให้สำนักตรวจสอบก่อนนำไปใช้

#### 4. รูปแบบและการแสดงเครื่องหมายการรับรอง หรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA

4.1 การเพิ่มและการลดขนาดของเครื่องหมายการรับรอง หรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้องใช้อัตราส่วนตามที่สำนักกำหนดในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามลำดับ ขนาดความสูงของเครื่องหมายการรับรอง (ไม่รวมหมายเลขการรับรอง) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.0 เซนติเมตร

เมื่อแสดงเครื่องหมายการรับรอง (ไม่รวมหมายเลขการรับรอง) หรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA บนวัสดุสำนักงาน โดยส่วนที่ไม่พับมีพื้นที่ไม่เกินกระดาษขนาด A4 เครื่องหมายการรับรองต้องมีความสูงไม่เกิน 3.0 เซนติเมตร ข้อความ “TESTING No.XXXX” และ/หรือ “PTP No.XXXX” และ/หรือ “RMP No.XXXX” ต้องอยู่ใต้เครื่องหมายการรับรอง ซึ่ง XXXX เป็นหมายเลขการรับรองที่ออกโดยสำนัก ถ้าพื้นที่มีขนาดมากกว่ากระดาษ A4 ขนาดของเครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้องมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกัน

ในทุกกรณีการแสดงผลการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้องถูกต้อง ชัดเจน โดยขนาดหรือสัดส่วนต้องไม่ผิดรูปแบบ และเป็นไปตามภาคผนวก ก และภาคผนวก ข ตามลำดับ

**สำเนา**

**เอกสารภายนอก**

4.2 เครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ต้องพิมพ์ด้วยสีดำ ซึ่งขอได้จากสำนัก

4.3 ห้องปฏิบัติการ หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง ต้องการอ้างถึงสถานะของการรับรองแทนการใช้เครื่องหมายการรับรอง จะต้องใช้ประโยคดังนี้ “ห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - XXXX ได้รับการรับรองโดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” หรือ “ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความชำนาญ - XXXX ได้รับการรับรองโดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” หรือ “ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง -XXXX ได้รับการรับรองโดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ” เท่านั้น

## 5. การยุติและการยกเลิกการใช้เครื่องหมายการรับรองหรือเครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA

5.1 เมื่อห้องปฏิบัติการและ/หรือ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง ถูกพักใช้การรับรอง (ทั้งหมดหรือบางส่วนของ การรับรอง โดยสมัครใจหรือถูกกำหนดโดยหน่วยรับรอง) รายงานผลการทดสอบ หรือรายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หรือ ใบรับรองวัสดุอ้างอิง หรือวัสดุอ้างอิง รวมถึงเอกสาร และข้อมูลเผยแพร่ หรือ ใบเสนอราคาที่มีเครื่องหมายการรับรอง หรือ เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรือการอ้างถึงสถานะที่ได้การรับรองต้องยุติการใช้ทันที

5.2 เมื่อห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองถูกเพิกถอนการรับรอง หรือพักใช้ทั้งหมด ห้องปฏิบัติการ และ/หรือผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและ/หรือผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงดังกล่าวต้องยุติการใช้เครื่องหมายการรับรอง หรือ เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA หรืออ้างถึงการรับรองในข้อเสนอการประมูลงาน/ใบเสนอราคา รายงานผลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ใบรับรองวัสดุอ้างอิง วัสดุอ้างอิง เอกสาร และข้อมูลเผยแพร่ทั้งหมดทันที


5.3 เมื่อห้องปฏิบัติการประสงค์จะยกเลิกการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ห้องปฏิบัติการต้องทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนัก

สำเนา

เอกสารภายนอก



## ภาคผนวก ก: เครื่องหมายการรับรอง

### 1. เครื่องหมายการรับรองสำหรับห้องปฏิบัติการ



เครื่องหมายการรับรองมีขนาดตาม  
ความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

### 2. เครื่องหมายการรับรองสำหรับผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

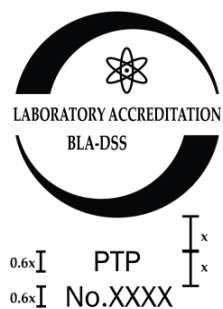

เครื่องหมายการรับรองมีขนาดตาม  
ความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

# สำเนา

# เอกสารภายนอก

3. เครื่องหมายการรับรองสำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง




เครื่องหมายการรับรองมีขนาดตาม  
ความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

สำเนา

เอกสารภายนอก

## ภาคผนวก ข : เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA

เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สำหรับห้องปฏิบัติการ

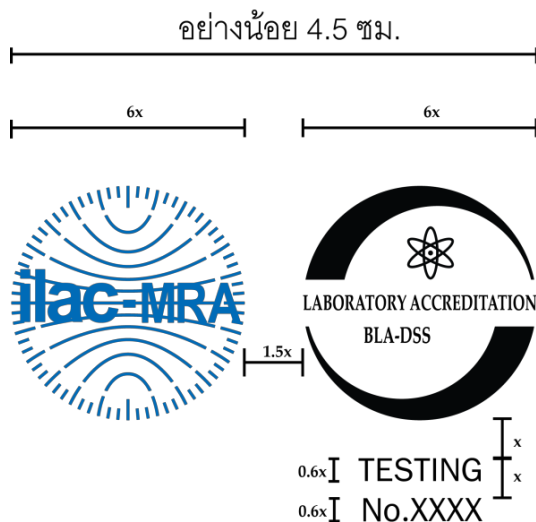

เครื่องหมายการรับรองมีขนาด  
ตามความกว้างไม่น้อยกว่า 4.5  
เซนติเมตร

# สำเนา

# เอกสารภายนอก